

# MT60 呼吸回路セット[ディスポ]



## RT125小児シングル熱線入回路(バイアスフロー用) 10入

商品コードNo. 052 23 020	リファレンスNo. RT125
最小販売個数 1	
注	セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

## RT225小児シングル熱線入回路(バイアスフロー用)+MR290 10入

商品コードNo. 052 23 050	リファレンスNo. RT225
最小販売個数 1	
注	セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

## RT100成人デュアル熱線入回路 10入

商品コードNo. 052 23 220	リファレンスNo. RT100
最小販売個数 1	
注	セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

## RT200成人デュアル熱線入回路(RT100)+MR290 10入

商品コードNo. 052 23 310	リファレンスNo. RT200
最小販売個数 1	
注	セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です



## 加温加湿器仕様



### ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カテーテルマウント ダブルシーベル10CM (25個) <sup>(注1)</sup>	035 22 111	1
カテーテルマウント ダブルシーベル15CM (25個) <sup>(注1)</sup>	035 22 121	1

(注1) いずれか1点を選んでください

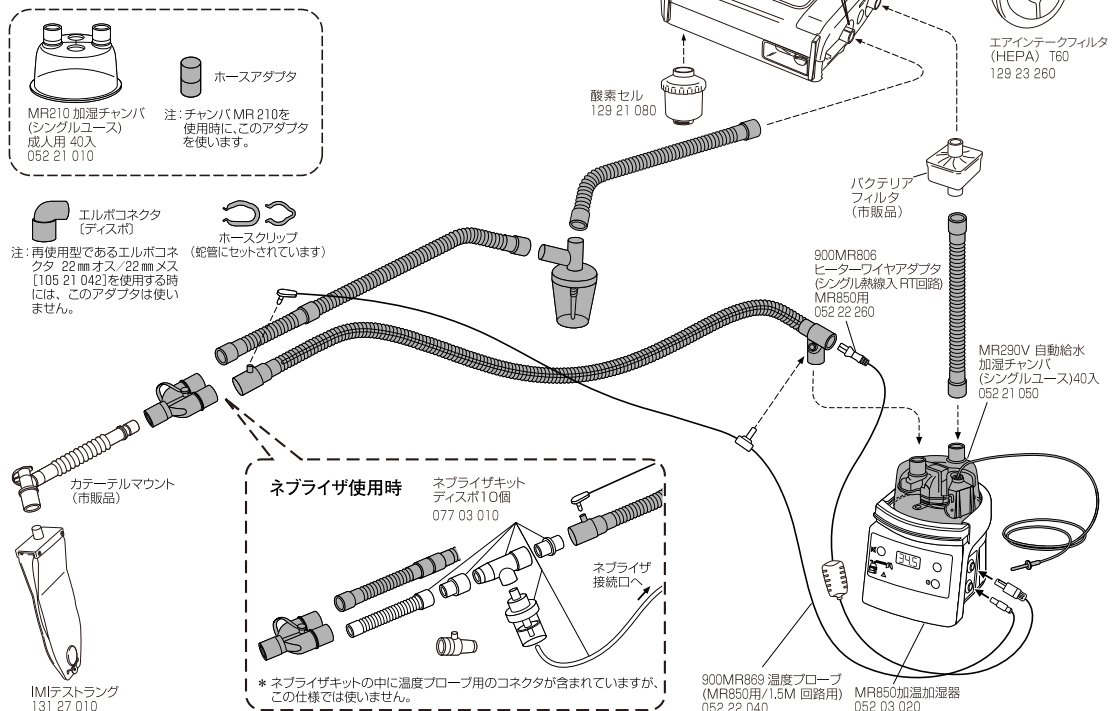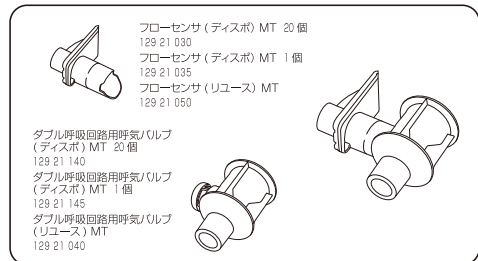

## 成人用ダブル呼吸回路(ディスポ)MT

商品コードNo. 129 22 030      リファレンスNo. 5000190  
 最小販売個数 1

注 セットの構成部品は図(濃く着色した部分)を参照してください。  
 ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

## 小児用ダブル呼吸回路(ディスポ)MT

商品コードNo. 129 22 070      リファレンスNo. 5500190  
 最小販売個数 1


注 セットの構成部品は図(濃く着色した部分)を参照してください。  
 ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

### ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カテーテルマウント ダブルシーベル10CM (25個) (注1)	035 22 111	1
カテーテルマウント ダブルシーベル15CM (25個) (注1)	035 22 121	1

(注1) いずれか1点を選んでください

## 人工鼻仕様

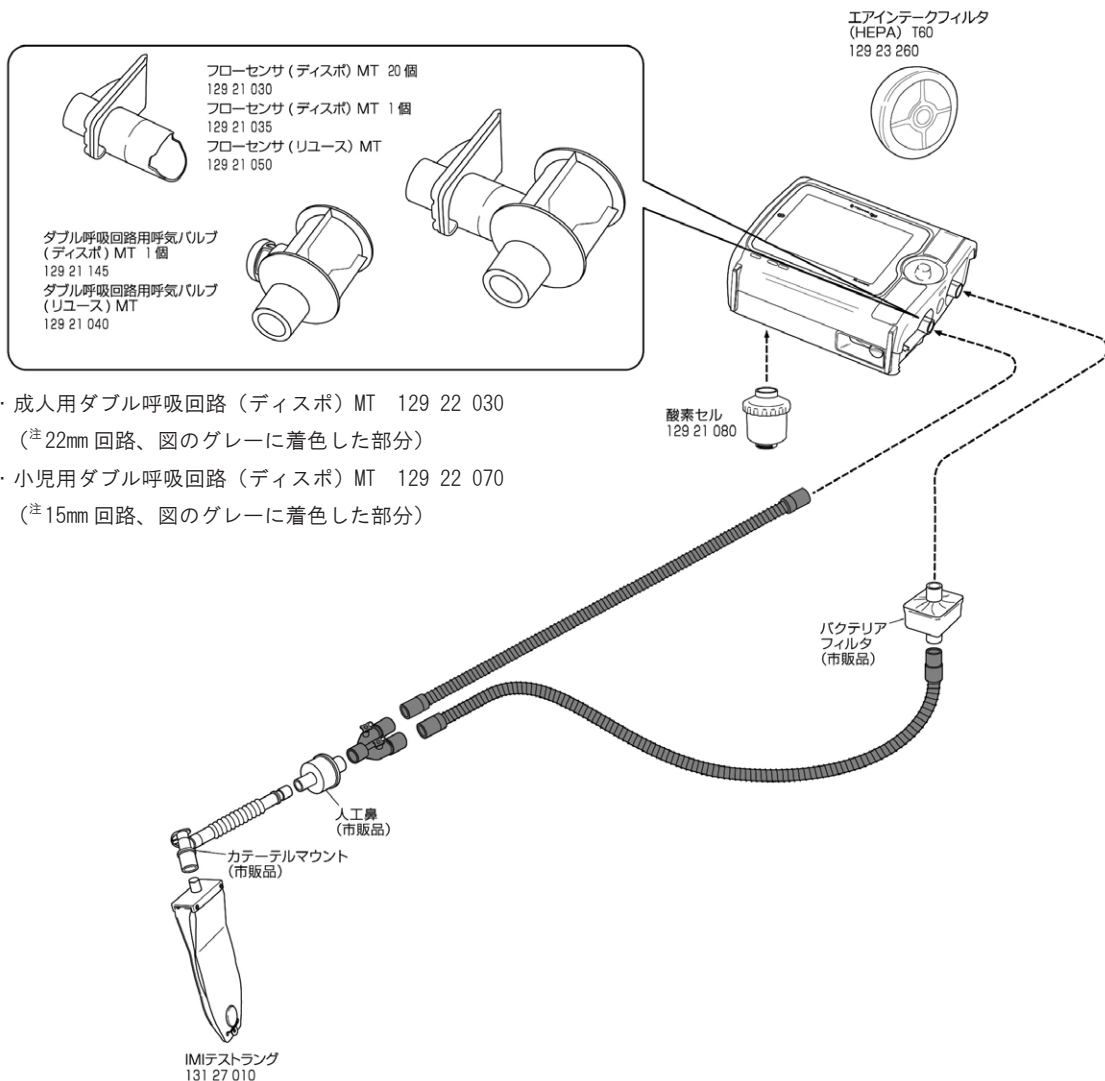

- ・成人用ダブル呼吸回路 (ディスポ) MT 129 22 030  
 (※22mm 回路、図のグレーに着色した部分)
- ・小児用ダブル呼吸回路 (ディスポ) MT 129 22 070  
 (※15mm 回路、図のグレーに着色した部分)